

重要なお知らせ

お客様各位

オリンパスメディカルシステムズ株式会社
医療機器安全管理責任者 村上 和士

レゼクトスコープ、レゼクト電極等の添付文書に関する 記載内容訂正のご連絡

拝啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。日頃は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

添付文書には生体接触部位の材料を記載することが求められていますが、このたび、レゼクトスコープ、レゼクト電極等の製品において、一部の材料が記載できていないことが判明いたしました。対象製品の正誤表を作成いたしましたのでご確認をお願いいたします。

なお、材料の記載を修正した添付文書は本年 12 月頃から順次公開させて頂く予定ですが、記載されました内容につきましては、製造元からの試験結果等にて安全性に影響のない事を確認しており、使用している材料等については変更も実施しておりませんので、ご安心してお使いいただけますようお願い申し上げます。ただし、ご使用にあたっては、患者に接触する材料についての最新情報を参照して、医療関係者または患者に、その材料への過敏症やアレルギーがないことを確認してください。

本問題による供給遅延が生じるなど、多大なご迷惑・ご心配をお掛けいたしておりますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。今後はこのようなことの無いよう再発防止を行ない、品質向上に努めて参ります。

敬具

1. 対象製品

A22021A, A22026A, A22027A
A22051A, A22052A, A22053A, A22054A
A22201A, A22201B, A22202A, A22205A, A22205B, A22206A
A22231A, A22231B
A22251A, A22258A
A22253A
A22255A
A22261A
WA22302D, WA22306D, WA22332D, WA22351C, WA22355C
A22201C, A22201D, A22205C, A22205D
A22221C, A22231C, A22251C, A22255C
A22265C
WA22558C
WA47050A, WA47051A, WA47052A, WA47054A
A37008A, A37009A, A37010A, A37011A, A37012A, A37013A

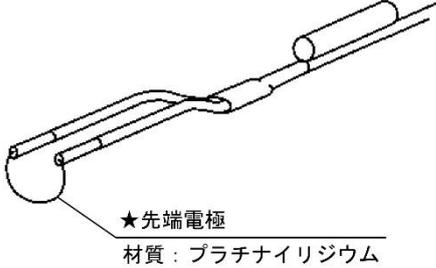
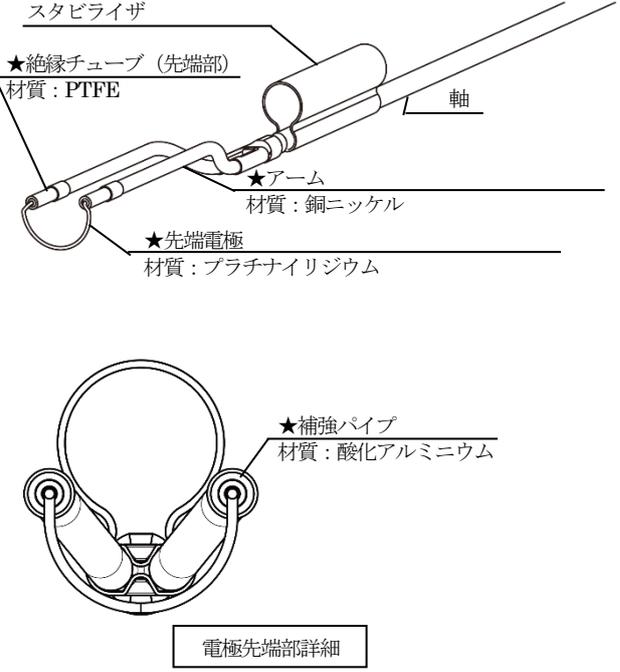
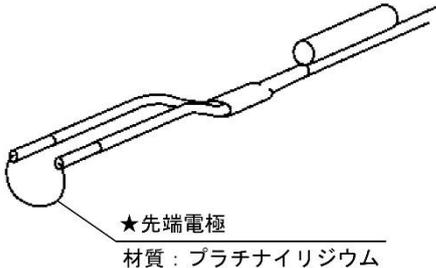
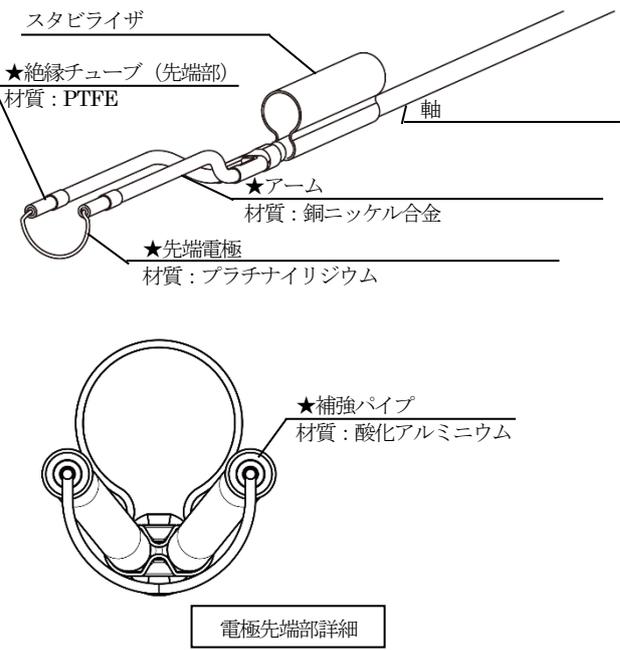
2. 本件に関するお問い合わせ先

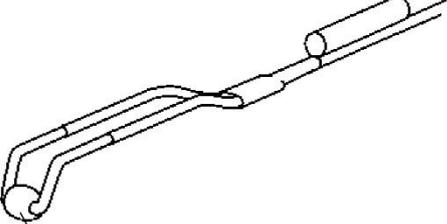
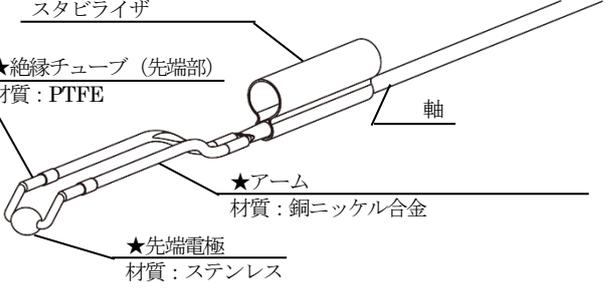
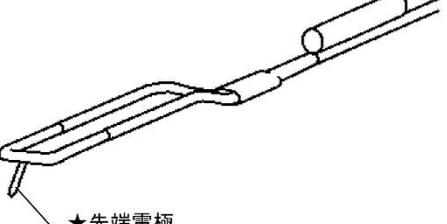
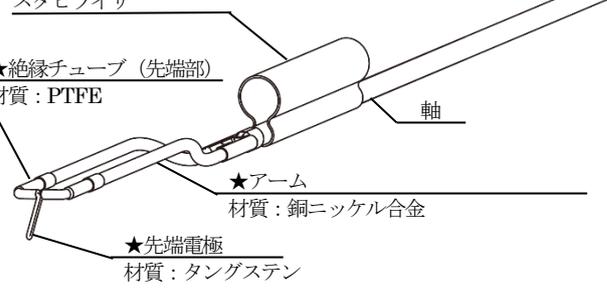
ご不明な点・ご質問等につきましては、弊社支店・営業所またはお客様相談センター（0120-41-7149）までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

正誤表

販売名：HF サージェリーシステム (医療機器番号：217ABBZX00002000)

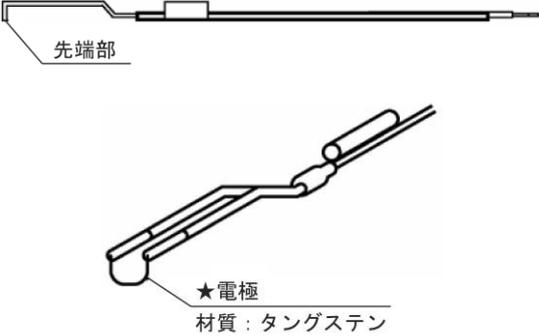
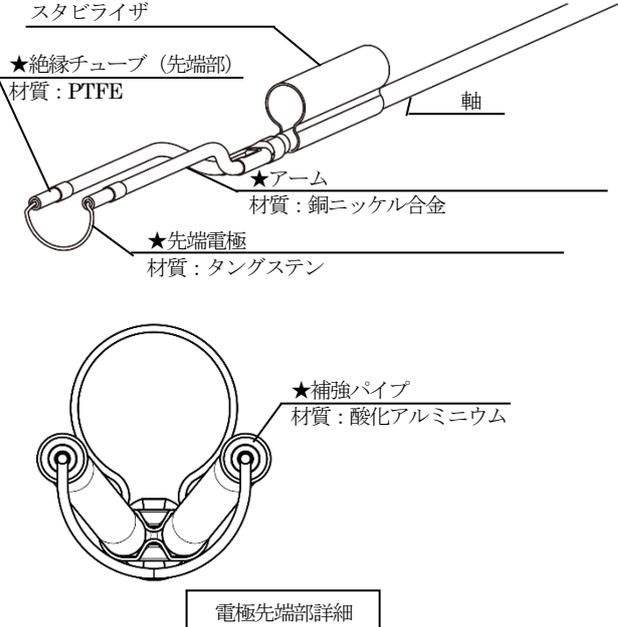
型式： WA22302D, WA22306D, WA22332D, WA22351C, WA22355C

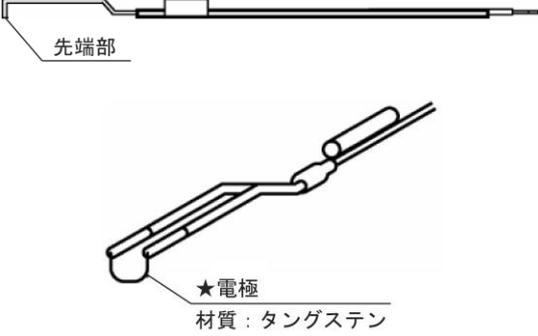
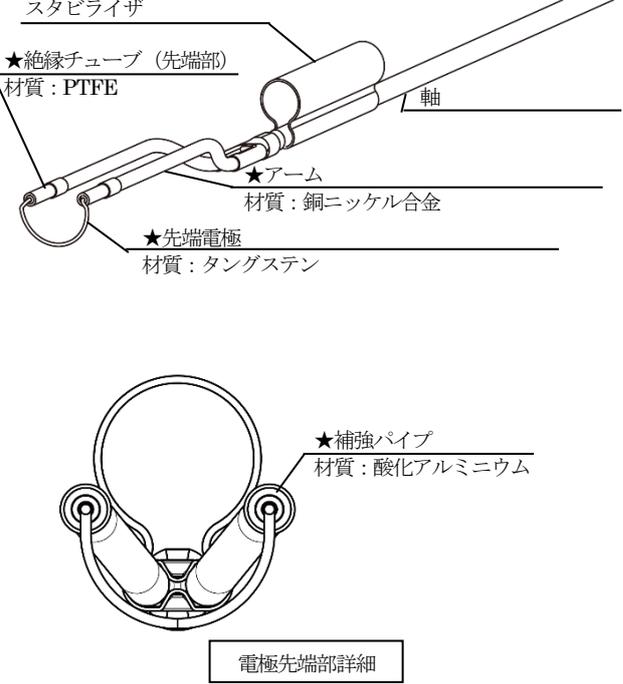
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WA22302D, WA22306D</p> <div data-bbox="212 465 683 510" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> </div>  <p>★先端電極 材質：プラチナイリジウム</p> | <div data-bbox="810 465 1238 510" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> </div>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル</p> <p>★先端電極 材質：プラチナイリジウム</p> <p>軸</p> <p>★補強パイプ 材質：酸化アルミニウム</p> <div data-bbox="979 1182 1174 1227" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>電極先端部詳細</p> </div> |
| <p>WA22332D</p> <div data-bbox="212 1305 683 1350" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> </div>  <p>★先端電極 材質：プラチナイリジウム</p> | <div data-bbox="810 1305 1238 1350" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> </div>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：プラチナイリジウム</p> <p>軸</p> <p>★補強パイプ 材質：酸化アルミニウム</p> <div data-bbox="995 2000 1190 2045" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>電極先端部詳細</p> </div> |

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WA22351C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★先端電極 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：ステンレス</p> |
| <p>WA22355C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★先端電極 材質：タングステン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：タングステン</p> |

販売名：ディスポーザブル電極（医療機器番号：21700BZY00147000）

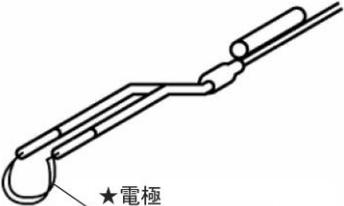
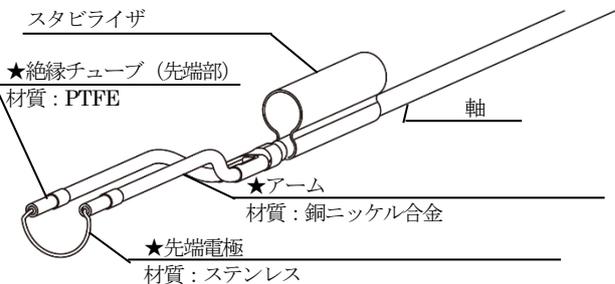

型式： A22201C, A22201D, A22205C, A22205D

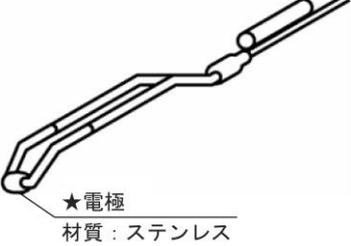
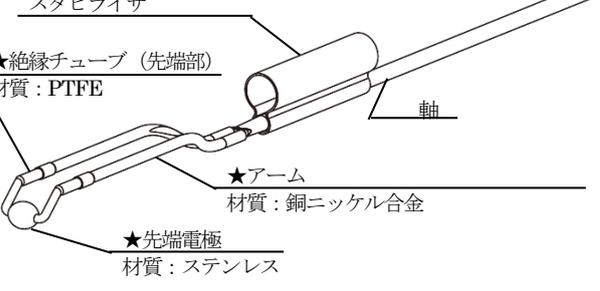
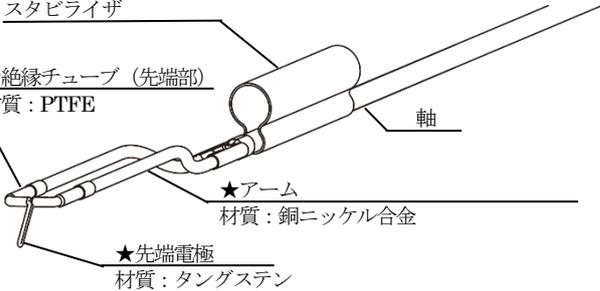
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22201C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p> <p>★電極 材質：タングステン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：タングステン</p> <p>★補強パイプ 材質：酸化アルミニウム</p> <p>電極先端部詳細</p> |

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="156 194 523 226">A22201D, A22205C, A22205D</p> <div data-bbox="199 248 667 288" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> </div>  <p data-bbox="236 367 304 389">先端部</p> <p data-bbox="379 607 448 629">★電極 材質：タングステン</p> | <div data-bbox="815 248 1241 309" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> </div>  <p data-bbox="831 349 954 371">スタビライザ</p> <p data-bbox="810 405 1038 454">★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p data-bbox="1225 443 1251 465">軸</p> <p data-bbox="1050 517 1251 566">★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p data-bbox="954 584 1129 633">★先端電極 材質：タングステン</p> <p data-bbox="1118 786 1342 835">★補強パイプ 材質：酸化アルミニウム</p> <div data-bbox="1018 992 1209 1037" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>電極先端部詳細</p> </div> |

販売名：ディスポーザブル電極（医療機器番号：21700BZY00147000）

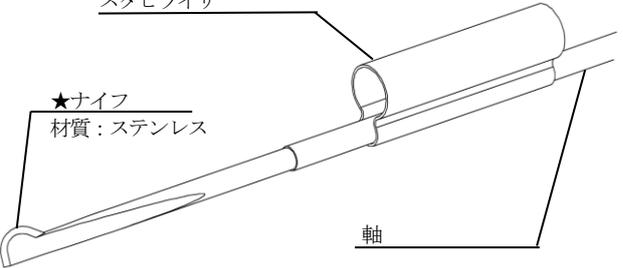
型式： A22221C, A22231C, A22251C, A22255C

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="156 271 395 300">A22221C, A22231C</p> <div data-bbox="199 324 667 365" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> </div>  <p data-bbox="236 443 304 468">先端部</p>  <p data-bbox="384 689 453 714">★電極</p> <p data-bbox="384 719 555 743">材質：ステンレス</p> | <div data-bbox="815 324 1257 365" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> </div>  <p data-bbox="834 412 954 436">スタビライザ</p> <p data-bbox="815 465 1038 492">★絶縁チューブ（先端部）</p> <p data-bbox="815 497 930 521">材質：PTFE</p> <p data-bbox="1273 501 1297 526">軸</p> <p data-bbox="1050 577 1134 602">★アーム</p> <p data-bbox="1050 607 1251 631">材質：銅ニッケル合金</p> <p data-bbox="954 642 1054 667">★先端電極</p> <p data-bbox="954 672 1107 696">材質：ステンレス</p>  <p data-bbox="1129 837 1251 862">★補強パイプ</p> <p data-bbox="1129 866 1347 891">材質：酸化アルミニウム</p> <div data-bbox="1026 1048 1219 1088" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <p>電極先端部詳細</p> </div> |

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22251C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p>  <p>★電極 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：ステンレス</p> |
| <p>A22255C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p>  <p>★電極 材質：タングステン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：タングステン</p> |

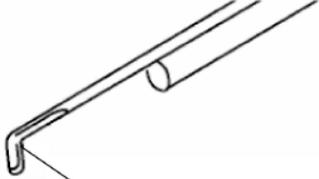
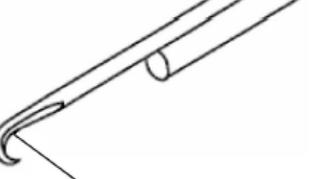
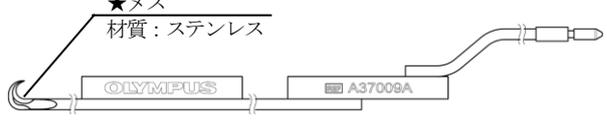
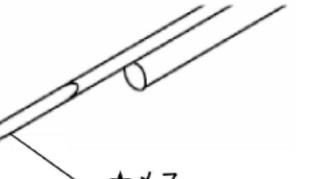
販売名：ディスポーザブル電極（医療機器番号：21700BZY00147000）

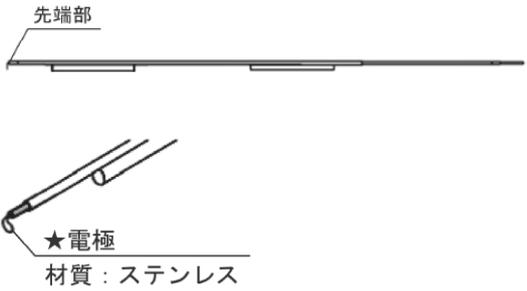
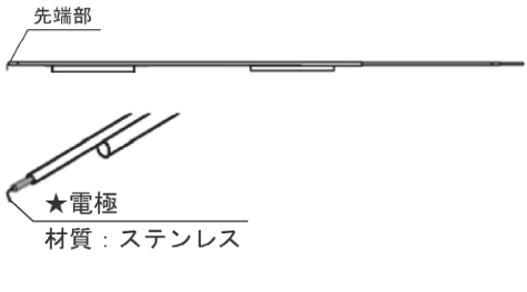
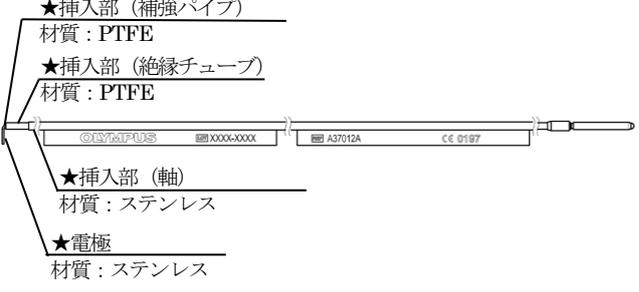
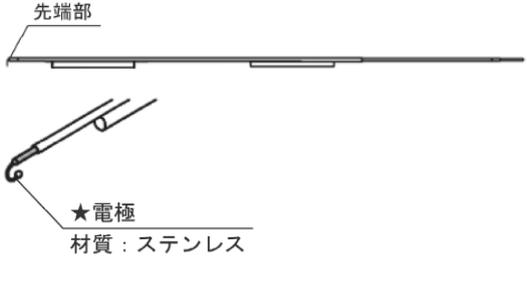
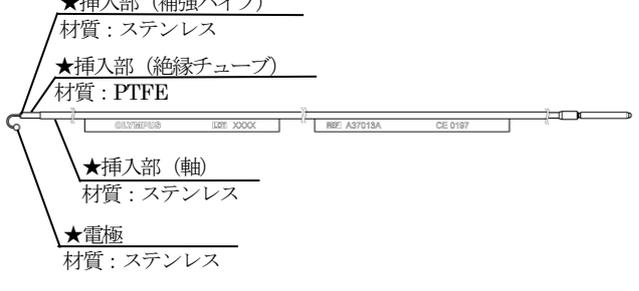
型式： A22265C

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22265C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★ナイフ 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★ナイフ 材質：ステンレス</p> <p>軸</p> |

販売名：ディスポーザブル電極（医療機器番号：21700BZY00147000）

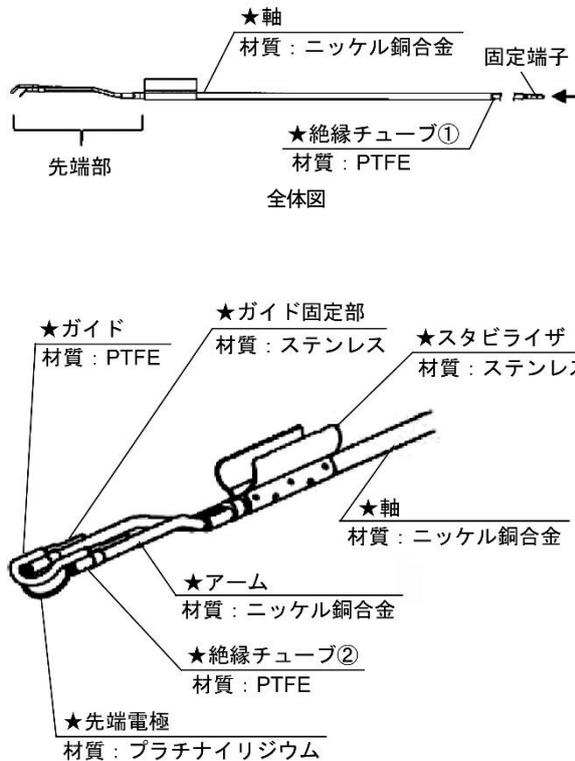
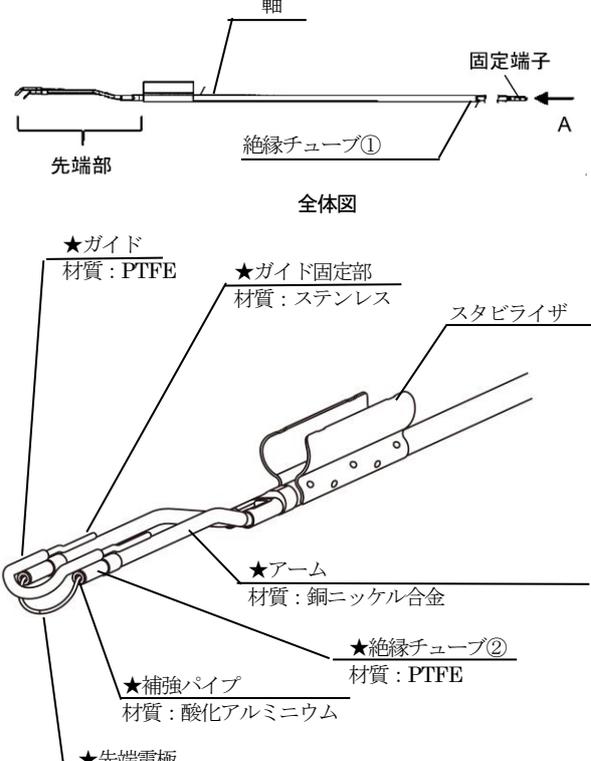
型式：A37008A, A37009A, A37010A, A37011A, A37012A, A37013A

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A37008A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p>  <p>★メス 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★メス 材質：ステンレス</p> <p>OLYMPUS A37008A</p> |
| <p>A37009A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p>  <p>★メス 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★メス 材質：ステンレス</p> <p>OLYMPUS A37009A</p> |
| <p>A37010A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p>  <p>★メス 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★メス 材質：ステンレス</p> <p>OLYMPUS A37010A</p> |

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A37011A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★挿入部（絶縁チューブ） 材質：PTFE</p> <p>★挿入部 材質：ステンレス</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> |
| <p>A37012A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★挿入部（補強パイプ） 材質：PTFE</p> <p>★挿入部（絶縁チューブ） 材質：PTFE</p> <p>★挿入部（軸） 材質：ステンレス</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> |
| <p>A37013A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>先端部</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★挿入部（補強パイプ） 材質：ステンレス</p> <p>★挿入部（絶縁チューブ） 材質：PTFE</p> <p>★挿入部（軸） 材質：ステンレス</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> |

販売名：TUEB 電極（医療機器番号：220ABBZX00179000）

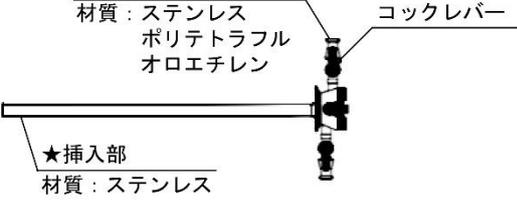
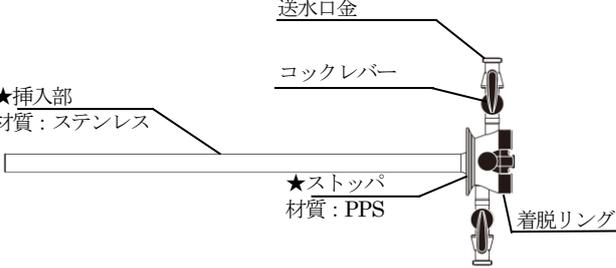
型式：WA22558C

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WA22558C</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★軸 材質：ニッケル銅合金</p> <p>★絶縁チューブ① 材質：PTFE</p> <p>★ガイド 材質：PTFE</p> <p>★ガイド固定部 材質：ステンレス</p> <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：ニッケル銅合金</p> <p>★絶縁チューブ② 材質：PTFE</p> <p>★先端電極 材質：プラチナイリジウム</p> <p>先端部拡大図</p> <p>アーム部 幅（最大径）：6.4mm 矢視A 拡大図</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> <p>軸</p> <p>絶縁チューブ①</p> <p>先端部</p> <p>固定端子</p> <p>★ガイド 材質：PTFE</p> <p>★ガイド固定部 材質：ステンレス</p> <p>スタビライザ</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★絶縁チューブ② 材質：PTFE</p> <p>★補強パイプ 材質：酸化アルミニウム</p> <p>★先端電極 材質：プラチナイリジウム</p> <p>先端部拡大図</p> <p>アーム部 幅（最大径）：6.4mm 矢視A 拡大図</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

型式：A22021A, A22026A, A22027A

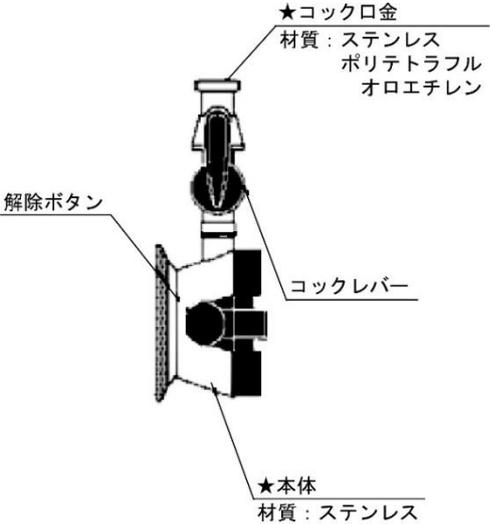
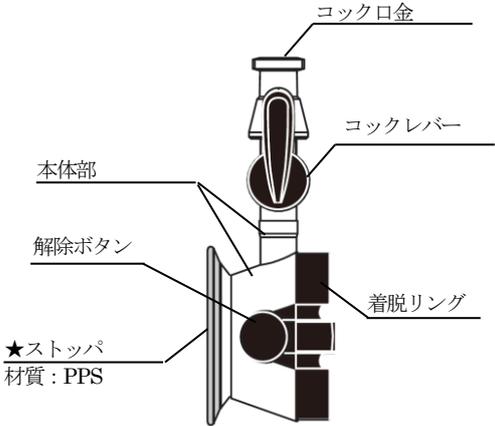
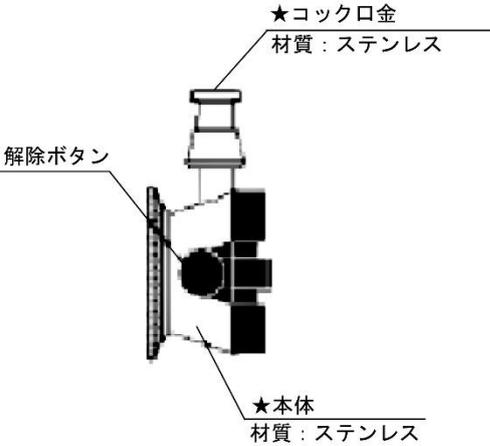
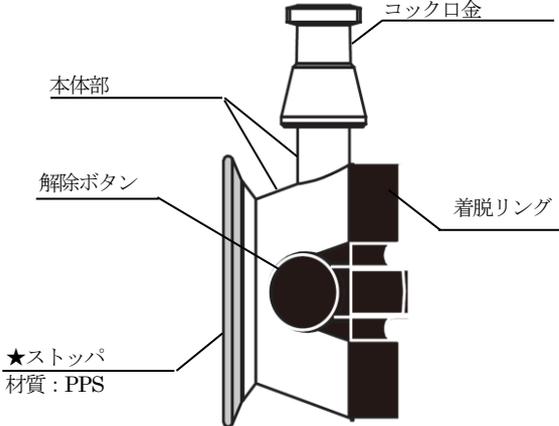
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22021A, A22026A, A22027A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> <p>★送水口金 材質：ステンレス ポリテトラフル オロエチレン</p> <p>★挿入部 材質：ステンレス</p> <p>コックレバー</p>  | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> <p>送水口金</p> <p>コックレバー</p> <p>★挿入部 材質：ステンレス</p> <p>★ストッパ 材質：PPS</p> <p>着脱リング</p> <p>※送水口金の材質はステンレスとなります。</p>  |

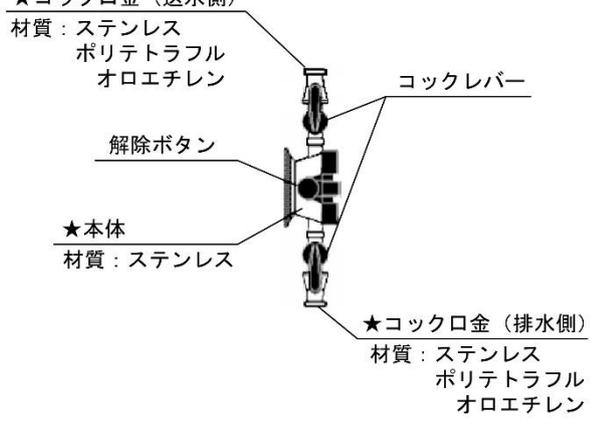
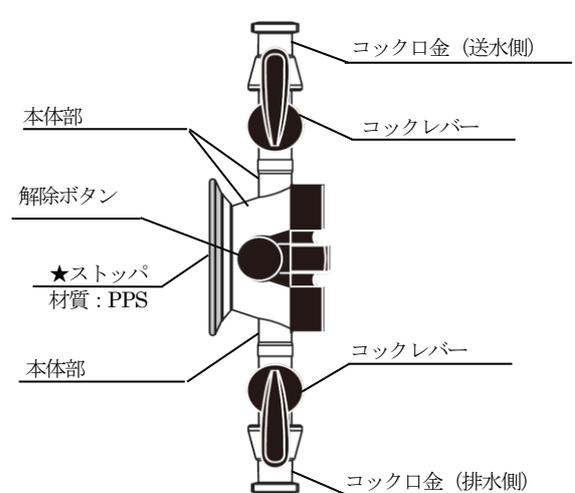
販売名：OES Pro パークティニアスネフロスコープ（医療機器番号：219ABBZX00001000）

OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

型式： A22051A, A22052A, A22053A, A22054A

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22051A, A22054A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★コックロ金 材質：ステンレス ポリテトラフル オロエチレン</p> <p>解除ボタン</p> <p>コックレバー</p> <p>★本体 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>コックロ金</p> <p>コックレバー</p> <p>本体部</p> <p>解除ボタン</p> <p>★ストoppa 材質：PPS</p> <p>着脱リング</p> <p>※コックロ金の材質はステンレスとなります。</p> |
| <p>A22052A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★コックロ金 材質：ステンレス</p> <p>解除ボタン</p> <p>★本体 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>コックロ金</p> <p>本体部</p> <p>解除ボタン</p> <p>★ストoppa 材質：PPS</p> <p>着脱リング</p> |

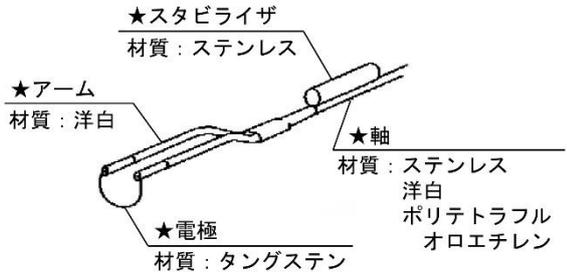
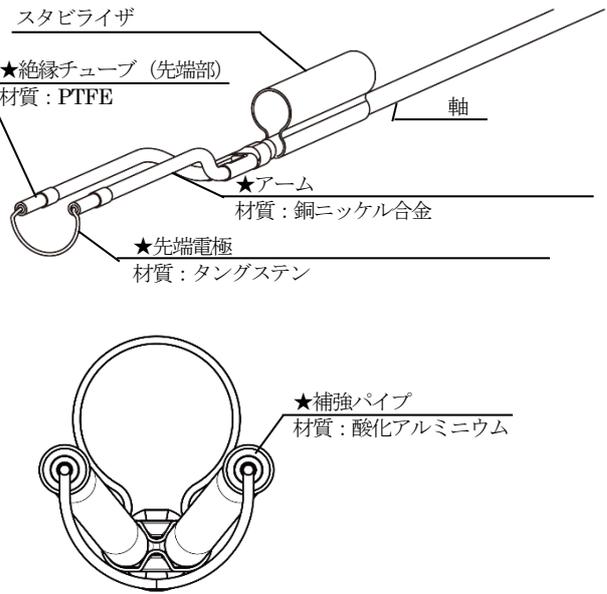
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22053A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> <p>★コックロ金（送水側） 材質：ステンレス ポリテトラフル オロエチレン</p> <p>解除ボタン</p> <p>★本体 材質：ステンレス</p> <p>コックレバー</p> <p>★コックロ金（排水側） 材質：ステンレス ポリテトラフル オロエチレン</p>  | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p> <p>コックロ金（送水側）</p> <p>コックレバー</p> <p>本体部</p> <p>解除ボタン</p> <p>★ストッパ 材質：PPS</p> <p>本体部</p> <p>コックレバー</p> <p>コックロ金（排水側）</p> <p>※コックロ金の材質はステンレスとなります。</p>  |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ (医療機器番号：218ABBZX00057000)

OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ (医療機器番号：21000BZY00372000)

OES 4000 レゼクトスコープ (医療機器番号：20800BZY00343000)

型式： A22201A, A22201B, A22202A, A22205A, A22205B, A22206A

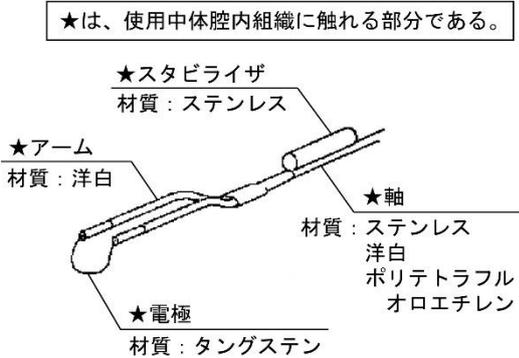
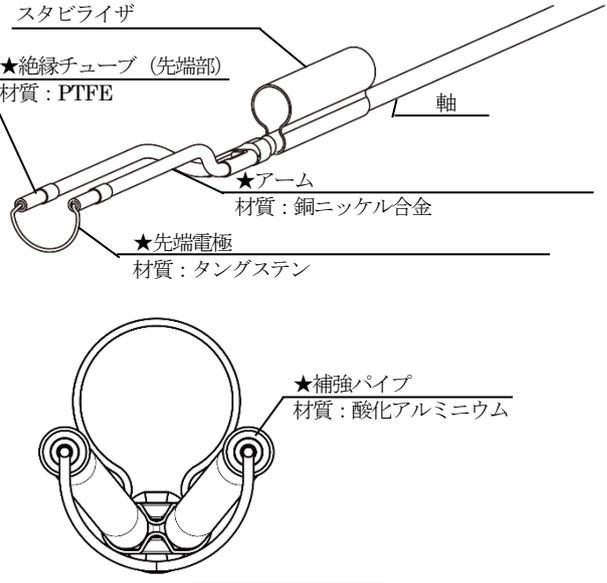
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22201A, A22201B, A22202A, A22205A, A22205B, A22206A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ（医療機器番号：21000BZY00372000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

型式： A22231A, A22231B

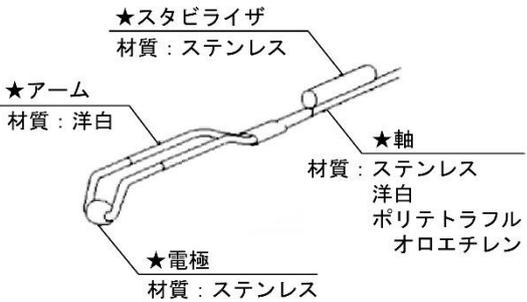
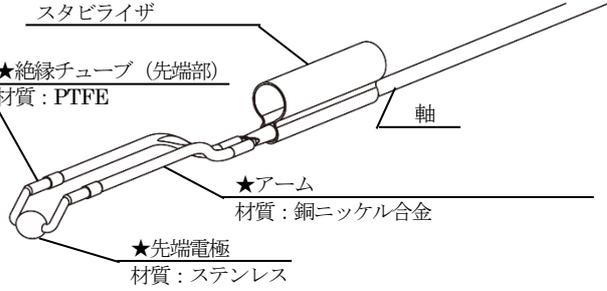
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22231A, A22231B</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> <p>★電極 材質：タングステン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ（先端部） 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：タングステン</p> <p>★補強パイプ 材質：酸化アルミニウム</p> <p>電極先端部詳細</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ（医療機器番号：21000BZY00372000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

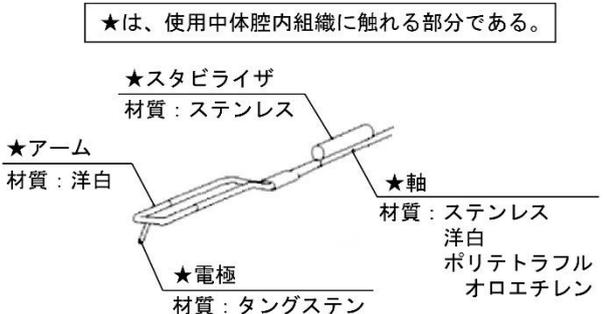
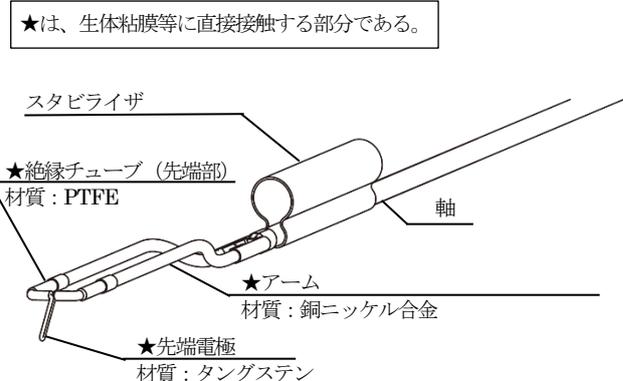
型式： A22251A, A22258A

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22251A, A22258A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ（先端部） 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：ステンレス</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

型式：A22253A

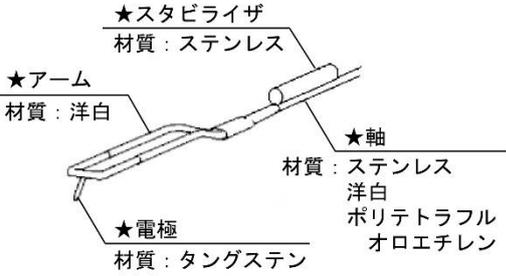
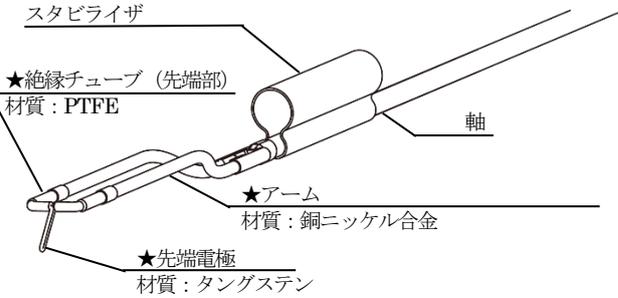
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22253A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★電極 材質：タングステン</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：タングステン</p> <p>軸</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ（医療機器番号：21000BZY00372000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

型式： A22255A

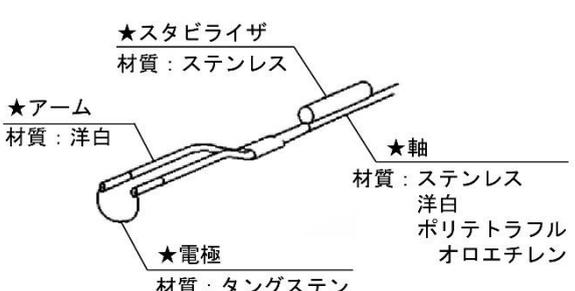
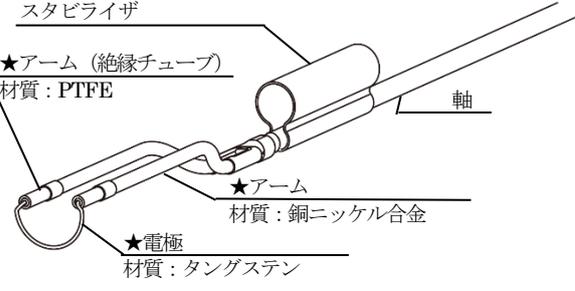
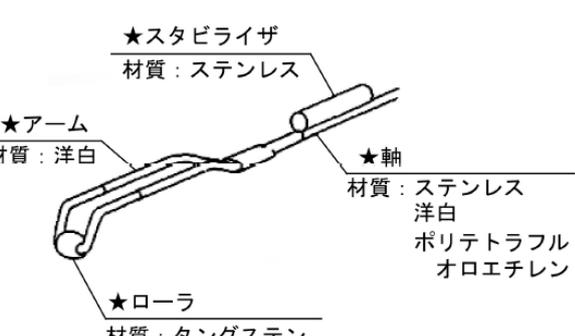
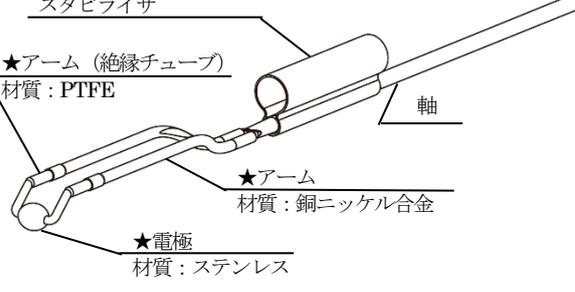
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22255A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★電極 材質：タングステン</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★絶縁チューブ (先端部) 材質：PTFE</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★先端電極 材質：タングステン</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

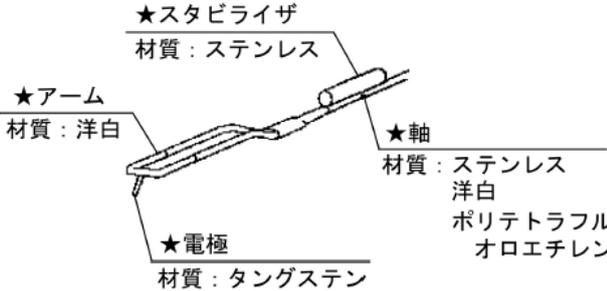
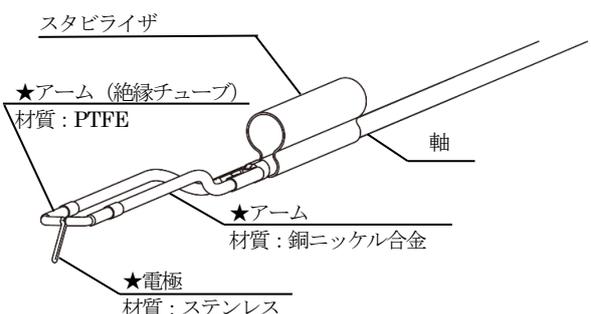
販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

OLYMPUS ヒステロレゼクトスコープ（医療機器番号：21000BZY00372000）

型式：WA47050A, WA47051A, WA47052A, WA47054A

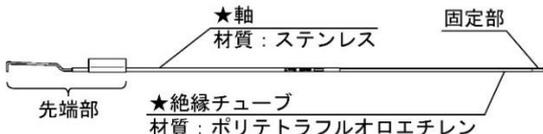
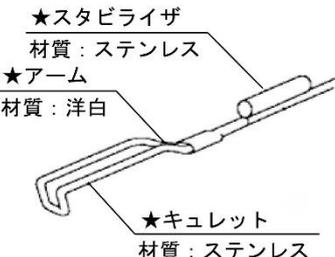
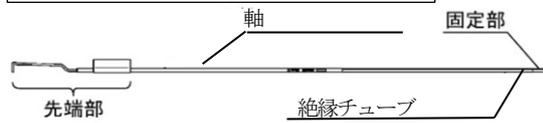
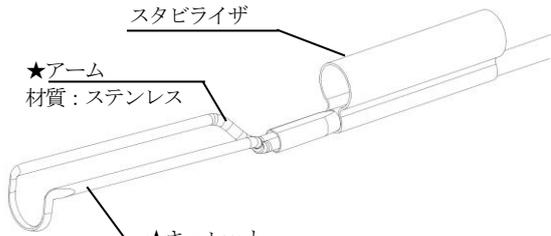
| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WA47050A, WA47051A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★電極 材質：タングステン</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★アーム（絶縁チューブ） 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★電極 材質：タングステン</p>  <p>★アーム（補強パイプ） 材質：酸化アルミニウム</p> <p>電極先端部詳細</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |
| <p>WA47052A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★ローラ 材質：タングステン</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★アーム（絶縁チューブ） 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>WA47054A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★電極 材質：タングステン</p> <p>★軸 材質：ステンレス 洋白 ポリテトラフル オロエチレン</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★アーム (絶縁チューブ) 材質：PTFE</p> <p>軸</p> <p>★アーム 材質：銅ニッケル合金</p> <p>★電極 材質：ステンレス</p> <p>※軸の材質は銅ニッケル合金となります。</p> |

販売名：OES Pro レゼクトスコープ（医療機器番号：218ABBZX00057000）

OES 4000 レゼクトスコープ（医療機器番号：20800BZY00343000）

型式：A22261A

| 現在案内している材料の情報 | 正しい材料の情報 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A22261A</p> <p>★は、使用中体腔内組織に触れる部分である。</p> <p>・全体図</p>  <p>★軸 材質：ステンレス</p> <p>★絶縁チューブ 材質：ポリテトラフルオロエチレン</p> <p>・先端部拡大図</p>  <p>★スタビライザ 材質：ステンレス</p> <p>★アーム 材質：洋白</p> <p>★キュレット 材質：ステンレス</p> | <p>★は、生体粘膜等に直接接触する部分である。</p>  <p>軸</p> <p>固定部</p> <p>先端部</p> <p>絶縁チューブ</p>  <p>スタビライザ</p> <p>★アーム 材質：ステンレス</p> <p>★キュレット 材質：ステンレス</p> |

以上